




Installation instruction

Electrodes
for Autodos M1-3 and MiniMaster

ALLPOOLS
ВОДА ЛЮБОЙ ФОРМЫ

Elektroder / Electrodes / Elektroden / Электроды / Elektrody

Montering av elektroder för mätning av Redox eller pH i Autodos Mät- & Doseringsutrustning från Pahlén.
 Assembly of electrode for measuring of Redox or pH in Autodos measuring and dosing equipment from Pahlén.
 Montage einer Elektrode für Messung von Redox oder pH in Autodos Mess- und Regelgerät von Pahlén.
 Монтаж электрода для измерения свободного хлора и pH в измерительно-дозировочной системе Autodos от Pahlen.
 Montaż elektrody do pomiaru reakcji redoks lub pH w urządzeniu pomiarowym i dozującym Autodos marki Pahlen.




Elektrod monterad i modul.
 Electrode assembled in module.
 Elektrode montiert in Modul.
 В сборе.
 Elektroda jest zamontowana w module.

	SVENSKA	ENGLISH	DEUTSCH	РУССКИЙ	POLSKI
1	Plugg	Plug	Stopfen	держатель электрода	Zaślepka
2	O-ring	O-ring	O-Ring	Уплотнительное кольцо	Pierścień uszczelniający typu „O-ring“
3	Etikett "Redox" alt. "pH"	Label "Redox" alt. "pH"	Etikett "Redox" oder "pH"	Этикетка "Redox" или "pH"	Etykieta „Redoks” lub „pH”
4	O-ring	O-ring	O-Ring	Уплотнительное кольцо	Pierścień uszczelniający typu „O-ring“
5	Plugg	Plug	Stopfen	Держатель электрода	Zaślepka
6	Elektrod Redox	Electrode Redox	Elektrode Redox	Электрод Redox	Elektroda redoks
7	Elektrod pH	Electrode pH	Elektrode pH	Электрод pH	Elektroda pH

Elektroder / Electrodes / Elektroden / Электроды / Elektrody


Montering av elektroder för mätning av fritt klor och pH i MiniMaster Mät- & Doseringsutrustning från Pahlén.
 Assembly of electrode for measuring of free chlorine and pH in MiniMaster measuring and dosing equipment from Pahlén.
 Montage einer Elektrode für Messung von freiem Chlor und pH in MiniMaster Mess- und Regelgerät von Pahlén.
 Монтаж электрода для измерения свободного хлора и pH в измерительно-дозировочной системе MiniMaster от Pahlen.
 Montaż elektrody do pomiaru reakcji redoks lub pH w urządzeniu pomiarowym i dozującym MiniMaster marki Pahlen.

Fritt klor, Free chlorine, Freiem Chlor, Свободный хлор, Chlor wolny



Elektrod monterad i modul.
 Electrode assembled in module.
 Elektrode montiert in Modul.
 В сборе.
 Elektroda jest zamontowana w module

Redox/pH, Reakcja redoks/pH

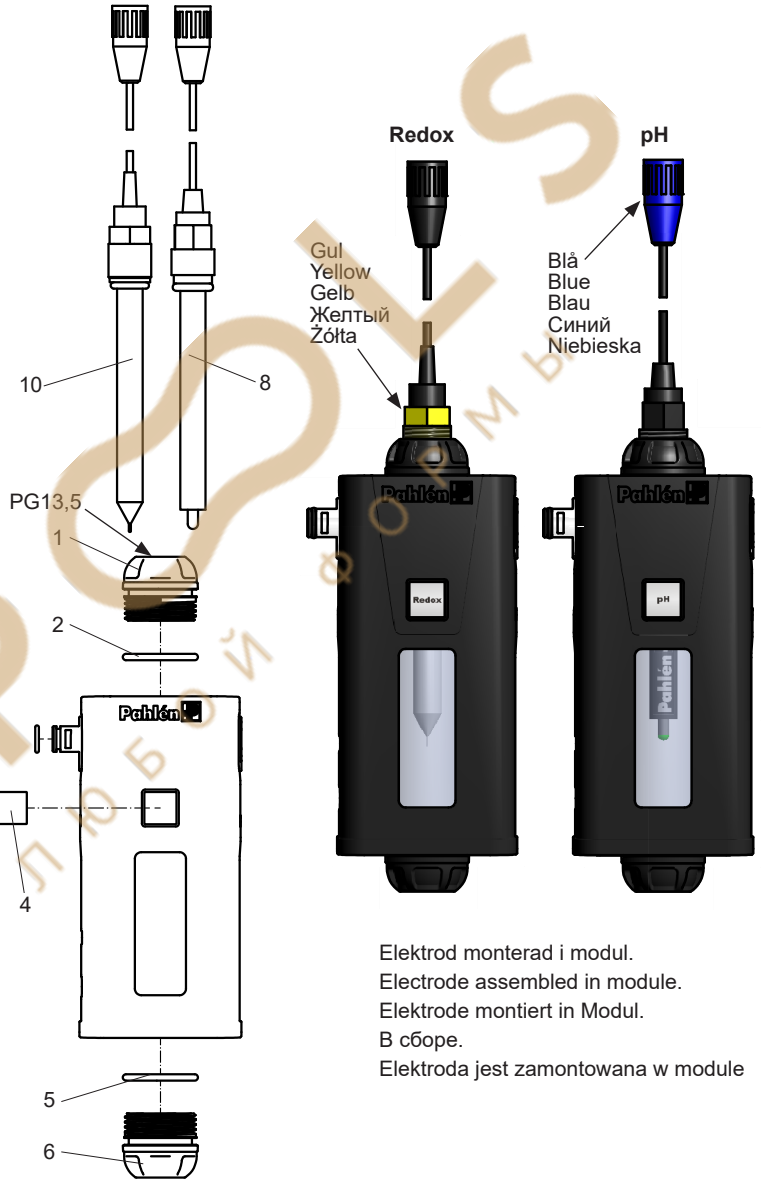

Elektrod monterad i modul.
 Electrode assembled in module.
 Elektrode montiert in Modul.
 В сборе.
 Elektroda jest zamontowana w module

	SVENSKA	ENGLISH	DEUTSCH	РУССКИЙ	POLSKI
1	Plugg	Plug	Stopfen	держатель электрода	Zaślepka
2	O-ring	O-ring	O-Ring	Уплотнительное кольцо	Pierścień uszczelniający
3	Etikett "Free Cl"	Label "Free Cl"	Etikett "Free Cl"	Этикетка "Free Cl"	Etykieta „Cl wolny”
4	Etikett "Redox" eller "pH"	Label "Redox" or "pH"	Etikett "Redox" oder "pH"	Этикетка "Redox" или "pH"	Etykieta „Redoks" lub „pH"
5	O-ring	O-ring	O-Ring	Уплотнительное кольцо	Pierścień uszczelniający
6	Plugg	Plug	Stopfen	Держатель электрода	Zaślepka
7	Elektrod fritt klor	Electrode free chlorine	Elektrode freies Chlor	Электрод свободный хлор	Elektroda chloru wolnego
8	Elektrod pH	Electrode pH	Elektrode pH	Электрод pH	Elektroda pH
9	⊕ fritt klor	⊕ free chlorine	⊕ freiem Chlor	⊕ свободный хлор	⊕ chlor wolny
10	Elektrod Redox	Electrode Redox	Elektrode Redox	Электрод Redox	Elektroda redoks